

Deliberazione N. 1213

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 02 DIC. 2011

OGGETTO: Autorizzazione integrazione apparecchiature per service Trattamenti dialitici per vari Reparti dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu". Anni cinque. Cod. CIG vari. Ditta FRESENIUS.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 02 DIC. 2011  
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Garau  
Coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo: Dott. Bruno Simola  
dal Direttore Sanitario: Dott. Remigio C. Puddu

SU proposta della S.C. Provveditorato;

PREMESSO che con deliberazione n. 1278 del 07.09.2010 è stata aggiudicata la procedura di gara per la fornitura in service di Trattamenti dialitici per vari Reparti dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" per un periodo di anni cinque, come sotto specificato:

RIF.	DITTA	IMPORTO ANNUO	IMPORTO 5 ANNI
Lotto A	FRESENIUS	€ 506.833,60 Iva compresa	€ 2.534.168,00 Iva compresa
Lotto B	FRESENIUS	€ 279.000,88 Iva compresa	€ 1.395.004,42 Iva compresa
Lotto C	FRESENIUS	€ 255.846,49 Iva compresa	€ 1.279.232,45 Iva compresa
Lotto D	MEDICAL	€ 72.727,62 Iva compresa	€ 363.638,08 Iva compresa
Lotto E	COOP. LA TRACCIA	€ 31.090,37 Iva compresa	€ 155.451,84 Iva compresa
Lotto F	FRESENIUS	€ 67.735,20 Iva compresa	€ 338.676,00 Iva compresa
Lotto G	MEDICAL	€ 35.767,68 Iva compresa	€ 178.838,40 Iva compresa
<b>Totale</b>		<b>€ 1.249.001,84 Iva compresa</b>	<b>€ 6.245.009,18 Iva compresa</b>

ACQUISITE le lettere prot. n. 808 – SB/df del 29.07.2011 (All. "A" fg. 1) e prot. n. 849 – SB/df del 09.08.2011 (All. "B" fg. 1) con cui la Ditta Fresenius ha proposto ad integrazione della strumentazione fornita in relazione al succitato service le seguenti apparecchiature:

- n. 2 apparecchiature BCM – Body Composition Monitor inerenti al Lotto A;
- n. 1 Minianalizzatore portatile LAL TEST necessario all'espletamento delle analisi microbiologiche, inerente al Lotto C;

RILEVATO che con successiva nota prot. n. 1130/2011 – SB/oo del 25.10.2011 (All. "C" fg. 1) la Ditta Fresenius ha comunicato che il valore nominale delle apparecchiature di che trattasi è il seguente:

- BCM – Body Composition Monitor – Codice H022011 - € 18.000,00 cad. Iva esclusa;
- PTS (strumento per il LAL Test) – Codice PTS100 - € 5.140,00 cad. Iva esclusa;
- Cartucce con sensibilità 0,005 EU/ML – Codice PTS20005F - € 515,00 cad. box da 10 pezzi Iva esclusa;

DATO ATTO che il Direttore della S.C. Nefrologia e Dialisi ha espresso parere favorevole alle proposte della Ditta Fresenius, come da annotazione in calce alle note prot. n. 808 – SB/df del 29.07.2011 (All. "A" fg. 1) e prot. n. 849 – SB/df del 09.08.2011 (All. "B" fg. 1);

RITENUTO pertanto di autorizzare l'integrazione in parola che non comporta alcun onere di spesa per questa Azienda, rinviando alla fase del collaudo la verifica della conformità dei beni alle norme di sicurezza;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

## D E L I B E R A

1) di autorizzare le proposte della Ditta Fresenius relative all'integrazione della strumentazione fornita in relazione al contratto in service Trattamenti Dialitici di cui alla deliberazione n. 1278/07.09.2010, le seguenti apparecchiature senza alcun aggravio di spesa per questa Azienda:

- n. 2 apparecchiature BCM – Body Composition Monitor - Codice H022011 - € 18.000,00 cad. Iva esclusa;
- n. 1 Minianalizzatore portatile LAL TEST - PTS (strumento per il LAL Test) – Codice PTS100 - € 5.140,00 cad. Iva esclusa;
- cartucce con sensibilità 0,005 EU/ML – Codice PTS20005F - € 515,00 cad. box da 10 pezzi Iva esclusa;

2) di verificare durante la fase del collaudo la conformità dei beni alle norme di sicurezza.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Bruno Sinola



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Garau



IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Remigio C. Puddu

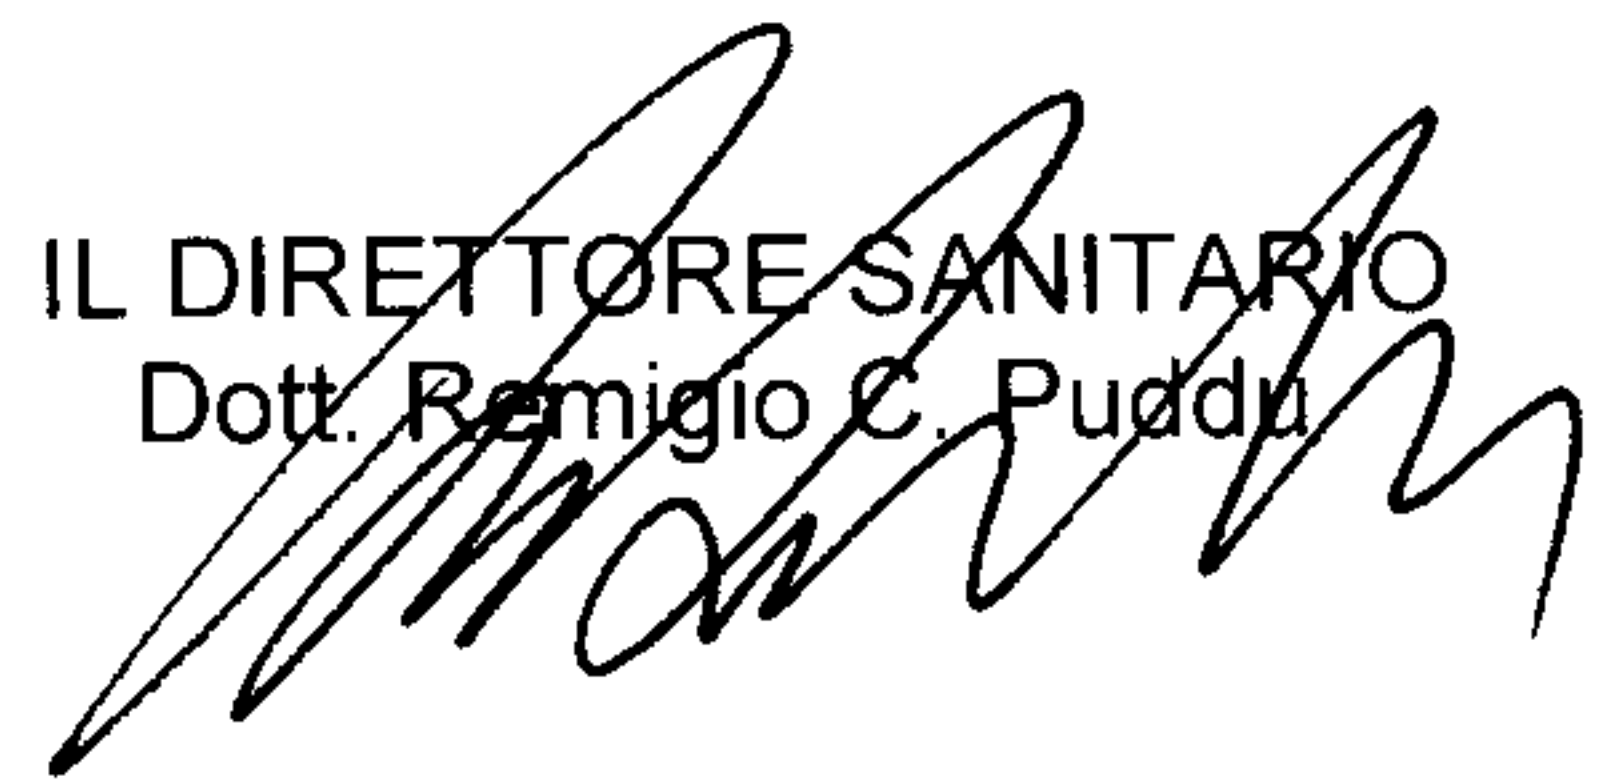

Dir. S.C. Provveditorato Dott. G.Casu \_\_\_\_\_   
Resp. Ufficio Acquisti Dott.ssa A.M. Marongiu \_\_\_\_\_ 