

Adottata dal Direttore Generale in data **02 DIC. 2011**

Deliberazione n. **1214**

OGGETTO: Aggiudicazione Acquisto in economia di due minidoppler per la S.C. di Chirurgia Toraco-Vascolare- Ditta Prodifarm - per un importo complessivo di € 3.114,54 iva inclusa.

CIG ZAC01A0F63

art. 29 comma 2 L.R. n.10 del 28.07.06

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Antonio Garau

Coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo: Dr. Bruno Simola

Direttore Sanitario: Dr. Remigio C. Puddu

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL **02 DIC. 2011**  
per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

**SU** proposta del Servizio Provveditorato;

**PREMESSO** che con nota del 29/08/11, approvata dal Direttore Sanitario e dal Capo Dipartimento, il Direttore della Chirurgia Toraco-Vascolare, richiede l'acquisto di due minidoppler per il proprio reparto(all. A fg.1);

**CONSIDERATO** che non risultano attive convenzioni regionali e consip relativa a detto materiale per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui alla legge finanziaria 2007;

**ATTESO** che, con nota prot. n.12206 del 29/09/2011, è stato richiesto preventivo di spesa a n.12 ditte, ai sensi del Dlgs 163/06, e che hanno risposto nei termini n.2 ditte, così come da verbale ricevimento offerte (all.B fg.1);

**VISTA** l'offerta della ditta Prodifarm e il quadro comparativo, allegati sotto la lettera C fg.3, con il parere di congruità e idoneità espresso da parte dell'utilizzatore, si propone l'aggiudicazione della fornitura a favore della ditta Prodifarm per conformità al capitolato inviato, per una spesa totale pari ad euro 3.114,54=IVA inclusa, così come sottodescritto:

MINIDOPPLER		PRODIFARM
cod. 00120100310	2	592,00
- sonda da 4MHZ cod. 00213040503	1	345,00
- sonda da 8MHZ cod. 0021380503	1	345,00
- sonde intraoperatorie da 8MHZ cod. 00254080010	2	175,00
- amplificatore indispensabile x le sonde intraop. cod. 00243080000	1	350,00
imponibile		2.574,00
iva 21%		
totale fornitura		3.114,54

**ATTESO** altresì che l'offerta della Ditta Terapon invece viene giudicata non idonea, perché non offre la sonda intraoperatoria così come richiesto dal capitolato;

%

*A*

*ME*

**VISTE** le LL.RR. n.10/06, 10/97 e n. 5/07, il DPGR n° 168/96 ed il D.lgs 163/06;

**CON** il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

**D E L I B E R A**


- 1) di aggiudicare alla Ditta Prodifarm la fornitura di due minidoppler, destinati alla S.C. di Chirurgia Toraco-Vascolare per un importo complessivo di euro 3.114,54 iva inclusa, spesa che grava sul numero 0501010801 del piano dei conti, così come sottodescritto:

MINIDOPPLER		PRODIFARM
cod. 00120100310	2	592,00
- sonda da 4MHZ cod. 00213040503	1	345,00
- sonda da 8MHZ cod. 0021380503	1	345,00
- sonde intraoperatorie da 8MHZ cod. 00254080010	2	175,00
- amplificatore indispensabile x le sonde intraop. cod. 00243080000	1	350,00
imponibile		2.574,00
iva 21%		
totale fornitura		3.114,54


- 2) di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti;

- 3) di comunicare l'adozione del presente atto all'assessorato igiene e sanità ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n.10 del 28.07.2006.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Bruno Simola

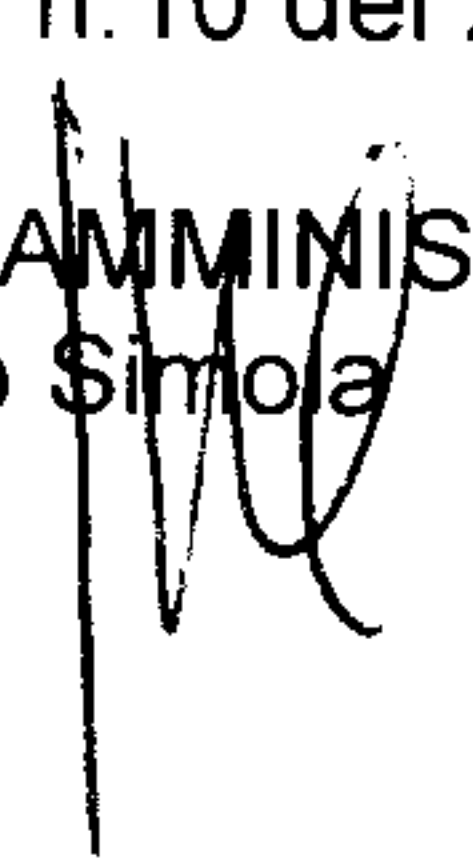

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Antonio Garau

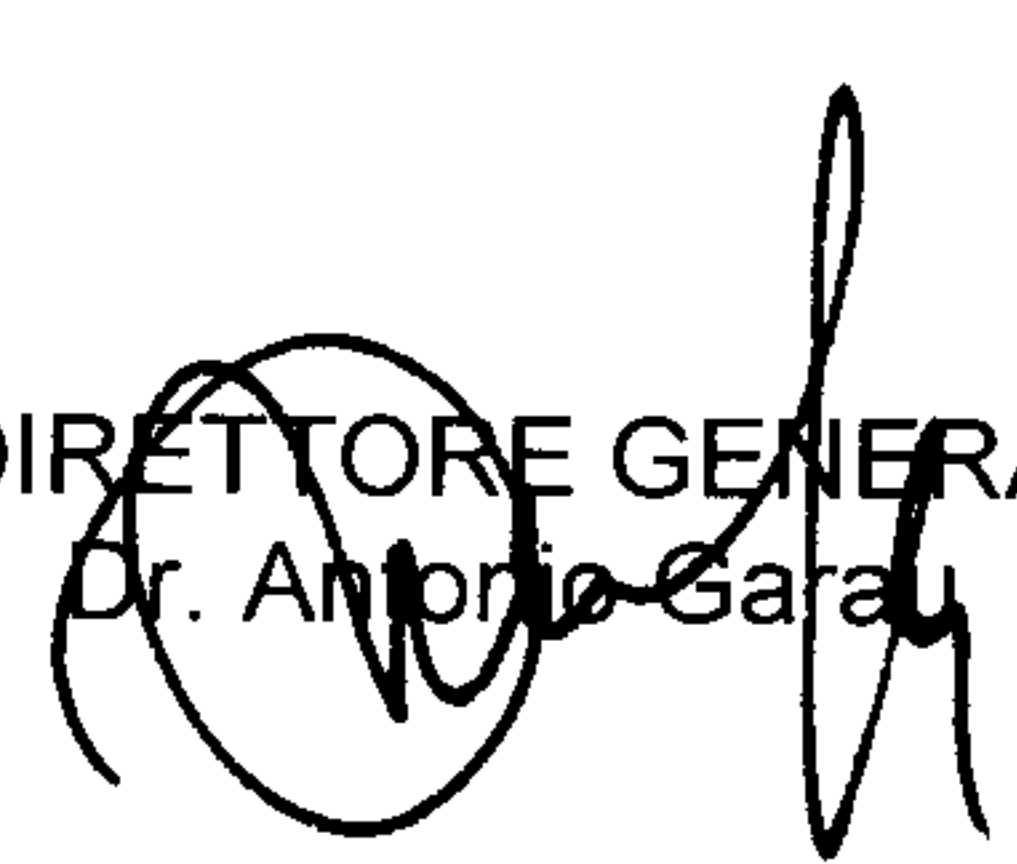


IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Remigio C. Puddu

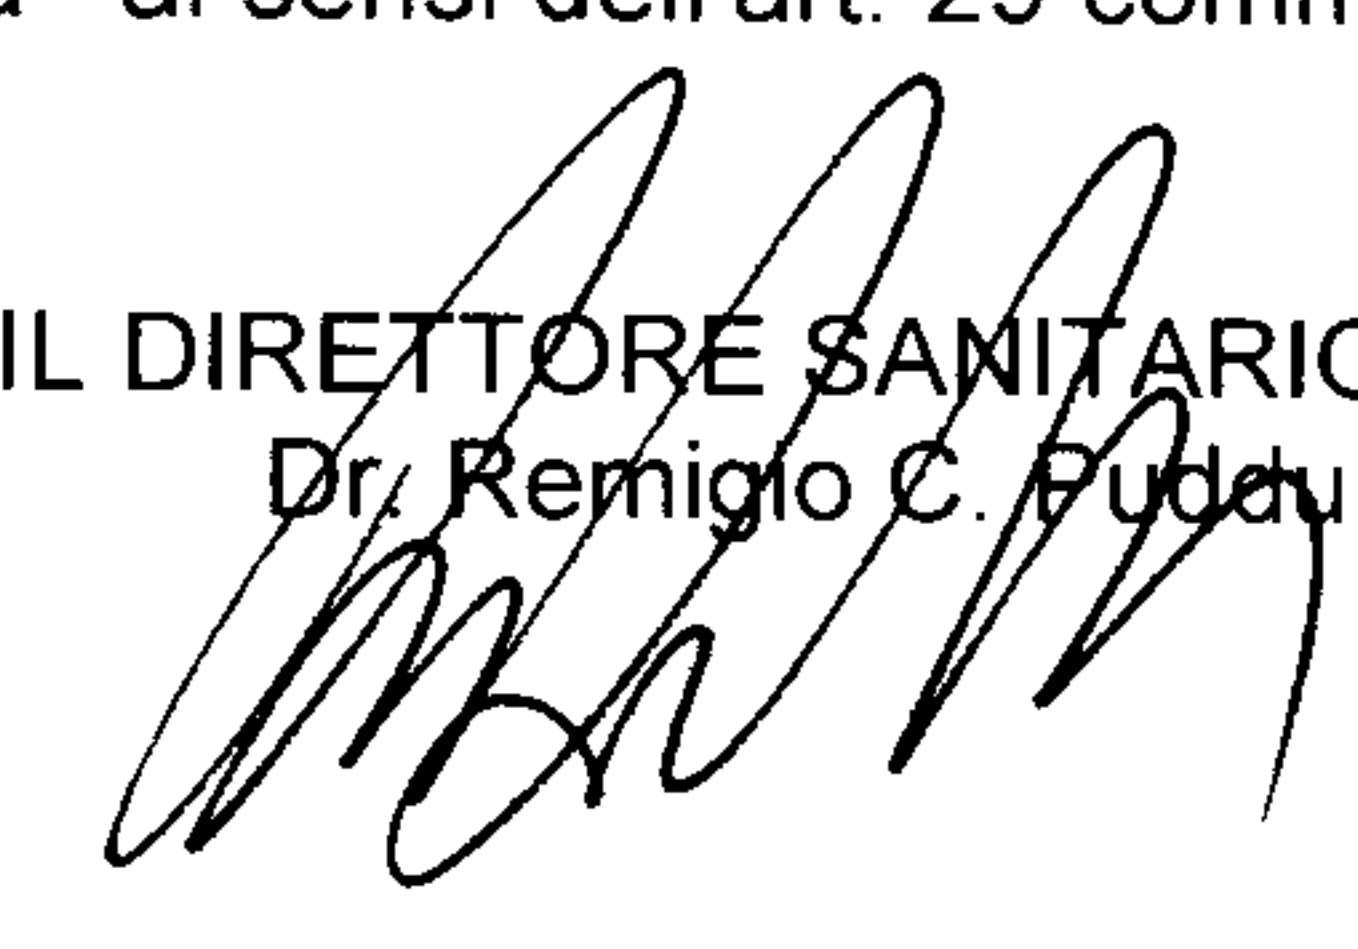

Direttore S.C. Provveditorato Dr. G. Casu

Responsabile procedimento  
Dr.ssa B. Martinez

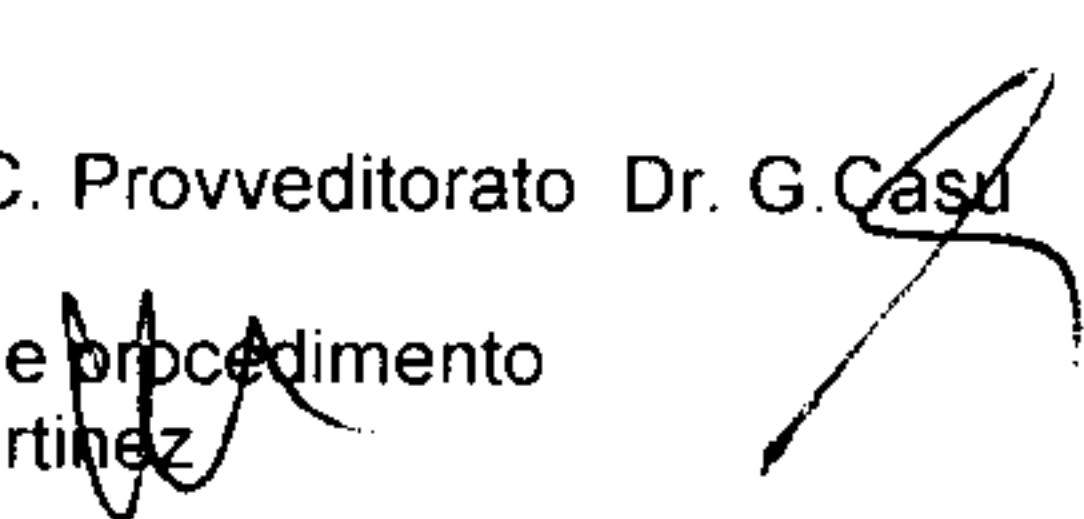

Responsabile Uff. Acquisti  
Dr.ssa A. Marongiu

