

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 873 _____

DEL 03.07.2019 _____

Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di n. 2 Ventilatori da Rianimazione da destinare alla SSD di Terapia Intensiva Post Operatoria Trapianti. Operatore Economico Medtronic Italia SpA. Spesa complessiva € 36.000,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig. Z4328D3747.

PDTD/2019/898

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 03.07.2019 _____ per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Visto** il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- Premesso** che con nota n. 5 del 22.01.2019, il Direttore della SSD di Terapia Intensiva Post Operatoria Trapianti del PO San Michele, ha richiesto la fornitura di n. 2 Ventilatori da Rianimazione da destinare alla propria Struttura (All. "A" fg. 3);
- Considerato** che, ai sensi dell'art. 36 co. 6 del D. Lgs 50/16 è stata pubblicata sulla piattaforma Sardegna Cat la RDO n. 338076, con la quale sono state invitati a presentare la propria offerta n. 12 Operatori Economici;
- Rilevato** che entro il termine di scadenza, è pervenuta nei termini l'offerta della Ditta Medtronic Italia SpA;
- Vista** la relazione nella quale l'utilizzatore ha espresso parere favorevole, relativamente ai prodotti proposti dalla suddetta Ditta (All. "B" fg. 1);
- Vista** l'offerta della Ditta Medtronic Italia SpA (All. "C" fg. 3);
- Tenuto Conto** che, nonostante le apparecchiature in argomento non siano ricomprese nel programma annuale e triennale degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che la loro acquisizione sia indifferibile essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
- Ritenuto** pertanto di dover assegnare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, in favore della Ditta Medtronic Italia SpA, la fornitura di n. 2 Ventilatori da Rianimazione da destinare alla SSD di Terapia Intensiva Post Operatoria Trapianti del PO San Michele per un importo complessivo pari ad € 36.000,00 oltre Iva di legge;
- Dato Atto** che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;
- Visti** il D.Lgs n. 50/16;


Segue determinazione n. 873 del 03.07.2019

D E T E R M I N A


per i motivi esplicitati in premessa:

1. di assegnare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, in favore della Ditta Medtronic Italia SpA, la fornitura di n. 2 Ventilatori da Rianimazione da destinare alla SSD di Terapia Intensiva Post Operatoria Trapianti del PO San Michele per un importo complessivo pari ad € 36.000,00 oltre Iva di legge;
2. di dare atto che l'importo di € 36.000,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A102020401 del Piano dei Conti, Centro di Costo - 090710;
3. di demandare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto, alimentata dai contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Sardegna prot. 001763 del 28/05/2015;
4. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis



SSD TIPO Trapianti
Direttore: Dott.ssa Elisabetta Pusceddu
DIPARTIMENTO CHIRURGICO

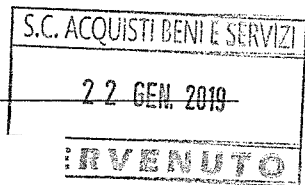

Cupici, 23.01.2019
nr. 05/2019

NP/2019/712
del 22/01/2019

Al Servizio Acquisti
Dott.ssa A. Foddis


Oggetto: acquisto N° 2 Ventilatori da rianimazione terapia intensiva

Si richiede N°2 Ventilatori elettronici completi di Carrello ad Alte Prestazioni, da Rianimazione / Terapia Intensiva, controllato da microprocessore, per l'utilizzo Adulto - Pediatrico - Funzionante con alimentazione Aria e O2 ad alta Pressione .

Unità di controllo Touch-Screen , con schermo LED o LCD da almeno 15 “ , ad alta definizione. Modalità di Impostazione tipo Smartphone per muoversi facilmente tra le pagine Funzioni . Orientabile in tutte le direzioni sino a 170° sull'asse verticale e 45° in inclinazione , per una ottimale visibilità. Visualizzazione in contemporanea delle impostazioni e del monitoraggio dei parametri ventilatori, compresa la spirometria. Deve poter visualizzare almeno 5 curve contemporaneamente compresi i loop Pressione-Volume – Flusso-Volume, con calcolo atto per atto del lavoro inspiratorio . Deve inoltre consentire il congelamento di tracciati e Loop potendoli poi scorrere indietro nel tempo sino ai 60 sec antecedenti. Deve permettere manovre di Meccanica Respiratoria Statica e Dinamica quali : NIF(forza insp.negativa)-P01-VC- Comp. Dinamica e Resist. dinamica – Monitoraggio dell' ETCO2 in tempo reale. Memorizzazione degli eventi d'allarme. Trend minimo 72 ore per almeno 53 parametri con possibilità di Marker manuali o automatici.

Impostazioni :


- Programmazione rapida in base al tipo di paziente Maschio / Femmina e l'altezza dello stesso - VC range da 25 ml sino a 2500 ml.
- Ventilazioni di tipo Volumetrico e Pressometrico.



- Modi : A/C – DLP (Doppio Livello di Pressione) – SIMV – SPONTANEA- CPAP – PRVC - NIV Avanzata sia in maschera che con casco , con software per la compensazione automatica delle perdite sino a 65 lt/m. nell'adulto , anche durante ventilazione Controllata sia Volumetrica che Pressometrica.
- Possibilità di variare la rampa inspiratoria sia in PS sia in PCV. In DLP il paziente deve poter triggerare a qualsiasi livello Pressorio, raggiungendo la Pressione di Supporto impostata. Possibilità di Volume garantito sia PCV sia in SPONTANEA.
- Ventilazione Proporzionale Assistita regolabile dall'operatore in %, con controllo automatico in continuo dei parametri di Elastanza e Resistenza , senza l'ausilio di dispositivi esterni invasivi e/o l'utilizzo di valori di CO2 integrati. Deve consentire una perfetta interazione paziente-Ventilatore .
- Ventilazione d'APNEA totalmente impostabile in base al tipo di paziente sia in PCV che in VCV. Alla chiamata del paziente ritorno alla ventilazione precedente.
- Possibilità di impostare il ciclaggio tra Inspirazione ed Espirazione durante l'attività spontanea del paziente. Regolazione da 1 % a 80% del Picco di flusso.
- Trigger a Pressione regolabile da 0,1 a 20 cm/H2O , utilizzabile come scelta clinica e non in caso di guasto del T. a Flusso- Trigger a Flusso regolabile da 0,5 a 20 lt/min. con flusso di Base di almeno 1,5 lit/min.

Predisposizione futura per un sofisticato Sistema di Trigger con Monitoraggio delle Asincronie Paziente/Ventilatore e compensazione delle stesse.

- Porta USB che consenta di scaricare e trasferire Dati , relativi a Pagine attive, che il ventilatore deve permettere di Memorizzare in maniera semplice ed efficace.
- Sensibilità di disconnessione regolabile dal 20% al 95% del volume corrente espirato.
- Possibilità di compensazione del lavoro respiratorio aggiunto dovuto al tubo endotracheale o alla cannula tracheostomica. Regolabile dal 10% sino al 100%.



Inoltre, il ventilatore dovrà avere una batteria di emergenza con autonomia minima di 60 min. con tecnologia Hot Swap che consenta la sostituzione senza spegnere il Ventilatore, bassi costi di gestione, possibilità di aggiornamento software per Up-Grade futuri, bracci di supporto e accessori d'uso. Garanzia Totale 24 Mesi.

Data 18/01/2019

EURO 20,000 €

**Il Direttore del Dipartimento
Chirurgico**

Dott. F. Zamboni

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
DIRETTORE: Dott. Fausto Zamboni

Il Direttore Sanitario

Dott. V. Atzeni

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vinicio Atzeni

**Il Direttore della SSD TIPO
Trapianti**

Dott.ssa E. Pusceddu

AO Brotzu - Cagliari
SSD TIPO TRAPIANTI
DIRETTORE: Dott.ssa Elisabetta Pusceddu
DIPARTIMENTO CHIRURGICO



rif. cc

Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 per fornitura di Ventilatori da Rianimazione da destinare alla SSD Terapia Intensiva Post Operatoria Trapianti Cod.Cig. Z4328D3747

VERBALE DI CONFORMITA' SCHEDE TECNICHE

Ditta Medtronic Italia Prodotto conforme.

AO Brotzu Cagliari
Il Direttore SSD Trapianti
SSD TIPO TRAPIANTI
Dott.ssa Elisabetta Pusceddu
DIPARTIMENTO CHIRURGICO

Il Direttore Dipartimento Chirurgico
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Dott. Fausto Zamboni
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
DIRETTORE: Dott. Fausto Zamboni

Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 per fornitura di Ventilatori da Rianimazione da destinare alla SSD Terapia Intensiva Post Operatoria Trapianti Cod.Cig. Z4328D3747

Dichiarazione di offerta economica

Il sottoscritto ...LAURA RACITI..... Nato a ...CATANIA..... il ...25/10/1966..... in qualità di ...PROCURATORE..... dell'operatore economico ...MEDTRONIC ITALIA S.P.A..... C.F. ...09238800156.....P. I.V.A. ...09238800156.....

(in caso di raggruppamento temporaneo)

Capogruppo del costituendo/o raggruppamento temporaneo con gli operatori economici:

.....
.....
.....

Dichiara

1. Di offrire il prezzo unitario di € _18.000,00___ (diconsi € _diciottomila/00___) IVA esclusa per un importo complessivo pari a € _36.000,00___ diconsi € (_trentaseimila/00___) IVA esclusa.

RDM _1120663___ CND_ Z1203010502___

Data, ...19/06/2019.....

Firma

...DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE...

Un Procuratore

LAURA RACITI

Attenzione

In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e in lettere prevarrà il prezzo più vantaggioso.

Spettabile
Azienda Ospedaliera G.Brotzu
Piazzale Alessandro Ricchi 1
09134 Cagliari CAMilano, 18 Giugno 2019
Nostro Protocollo N: ITT0018314/2019/rf**OGGETTO: Procedura Negoziata per fornitura di Ventilatori da Rianimazione da destinare alla SSD
Terapia Intensiva Post-Operatoria Trapianti – CIG Z4328D3747**

La scrivente MEDTRONIC ITALIA S.p.A. con sede a Milano, Via Varesina 162, CAP 20156, numero fax 02.241381, PEC (posta elettronica certificata): medtronicitalia.gare@legalmail.it, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09238800156, codice attività: 51462, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano - al n. 09238800156 REA (Repertorio Economico Amministrativo) al n. 1275682 - Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette territorialmente competente: Milano - Settori Grandi Contributi - Via Manin 27, nella persona del Procuratore LAURA RACITI nato/a a CATANIA (CT), il 25/10/1966 e residente a TRUCCAZZANO (MI) in Via San Giovanni Bosco 20/b, codice fiscale: RCTLRA66R65C351B, nominato/a con Atto del 13/06/2018 n. 17.675 banca d'appoggio BANK OF AMERICA N.A. - Via Manzoni, 5 - 20121 MILANO - A.B.I. 03380 C.A.B. 01600 C/C 12510016 Codice IBAN IT07A0338001600000012510016 Codice CIN: A, con la presente

OFFRE:

CODICE	NOME MODELLO	DESCRIZIONE	SCONTO APPLICATO	PREZZO GIA SCONTATO	IVA %
980X1ITDIEC	VENTILATORE POLMONARE PB980	Ventilatore Polmonare PB 980 senza Batterie - Versione X1 (Unità con Carrello) - Conf. 1 pezzo CND: Z1203010502 Repertorio:1120663 Classe CE: Classe IIb Certificato CE: G1180277790046	10,00 %	€ 18.000,00 (diciottomila/00)	22.00

Il seguente accessorio opzionale:

CODICE	NOME MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO OFFERTO A CONF.	IVA %
10043551 Accessori D'Uso	GRUPPO FILTRO ESPIRATORIO ADULTI /PEDIATRICO PER VENTILATORE PB980 MONOPAZIENTE	Gruppo Filtro Espiratorio Antibatterico Adulto / Pediatrico con Raccogli Condensa per Ventilatore PB980 - Monopaziente - Conf. 12 pezzi CND: R040199 Repertorio:1160137 Classe CE: Classe IIa Certificato CE: G1180277790046	€ 114,00 (centoquattordici/00)	22.00

Medtronic

Si offrono i seguenti codici in sconto merce:

CODICE	NOME MODELLO	DESCRIZIONE
10122272	SOFTWARE LEAK SYNC FACTORY INSTALL PER VENTILATORE PB980	Software LEAK SYNC Adulto / Pediatrico / Neonatale per Ventilatore PB980 - Installazione in Fabbrica - Conf. 1 pezzo CND: Z1203010582 Repertorio:1434076/R Classe CE: Classe IIb Certificato CE: G1180277790046
10122273	SOFTWARE BILEVEL 2.0 FACTORY INSTALL PER VENTILATORE PB980	Software BILEVEL 2.0 (include i Software: BILEVEL, TUBE COMPENSATION, VOLUME VENTILATION +, ADVANCED RESPIRATORY MECHANICS, TREND KIT) Adulto / Pediatrico / Neonatale per Ventilatore PB980 - Installazione in Fabbrica - Conf. 1 pezzo CND: Z1203010582 Repertorio:1434077/R Classe CE: Classe IIb Certificato CE: G1180277790046
10097250	SOFTWARE ETCO2 MONITOR FACTORY INSTALL PER VENTILATORE PB980	Software Capnografia EtCO2 Adulto / Pediatrico / Neonatale per Ventilatore PB980 - Installazione in Fabbrica - Conf. 1 pezzo (Necessita del codice 10087409 e di un Adattatore a scelta) CND: Z1203010582 Repertorio:1434080/R Classe CE: Classe IIb Certificato CE: G1180277790046
10122271	SOFTWARE PAV+ FACTORY INSTALL PER VENTILATORE PB980	Software PAV+ Adulto / Pediatrico (> 25 kg) per Ventilatore PB980 - Installazione in Fabbrica - Conf. 1 pezzo CND: Z1203010582 Repertorio:1434068/R Classe CE: Classe IIb Certificato CE: G1180277790046
10086042	Batteria ricaricabile agli Ioni di Litio per Ventilatore Polmonare PB980	Batteria Ricaricabile agli Ioni di Litio per Ventilatore Polmonare PB 980 - 1 ora di autonomia - Conf. 1 pezzo (Non inclusa nei ventilatori modelli X1, X2 e X3. Massimo 2 batterie installabili sui modelli X1 e X2. Massimo 4 batterie installabili sul modello X3) Repertorio:Classe 1
10087409	SENSORE CAPNOGRAFIA PER PB980	Sensore Capnografia per Ventilatore PB980 - Conf. 1 pezzo (Necessità del Software Capnografia EtCO2 e di un Adattatore a scelta) CND: Z1203020480 Repertorio:1120871 Classe CE: Classe IIb Certificato CE: G1180277790046

Distinti saluti

Medtronic Italia S.p.A.

Un Procuratore

Laura Raciti