

Adottata dal Commissario in data **19 APR. 2010**

**Oggetto:** riparazione Microscopio modello Pentero .

---

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal **20 APR. 2010** per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

---

Il Commissario	Dr. Antonio Garau
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dr. Bruno Simola
Direttore Sanitario	Dr. Roberto Sequi

---

**Acquisita** la richiesta 2010024/05.03.2010 della S.C. Neurochirurgia, si rende necessario provvedere per la riparazione del Microscopio Zeiss modello Pentero – matricola 6631401701 al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività del citato Servizio.

**Atteso** che la S.S. Fisica e Tecnologia, ha individuato la Ditta **Zeiss** quella più idonea per l'esecuzione del lavoro richiesto, in quanto Fabbriante dell'apparecchiatura di detta apparecchiatura, richiedendo preventivo di spesa .

**Considerato** che il preventivo di spesa n. 1022781014/01.04.2010 formulato dalla Ditta **Zeiss** è di Euro **1.569,60** Iva inclusa.

**Recepito** che il Responsabile di Fisica e Tecnologia Sanitaria ha dichiarato che il prezzo è congruo.

**Verificata** la Legge Regionale 10/97 .

**Visto** il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.

**DELIBERA**



Ai sensi delle normative vigenti affidare alla Ditta **Zeiss** l'esecuzione dei lavori di riparazione dell'apparecchiatura in oggetto.

Demandare al Responsabile di Fisica e Tecnologia Sanitaria il controllo/verifica sulla regolare esecuzione dei lavori di riparazione svolti dalla Ditta.


Imputare la spesa sul Conto n. 0507020103.

Trasmettere al Servizio Bilancio la documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della esecuzione dei lavori svolti, per l'emissione dell'ordine di pagamento di Euro **1.569,60** alla Ditta **Zeiss**.


**Il Direttore Amministrativo**  
Dr. Bruno Simola



**Il Direttore Sanitario**  
Dr. Roberto Sequi

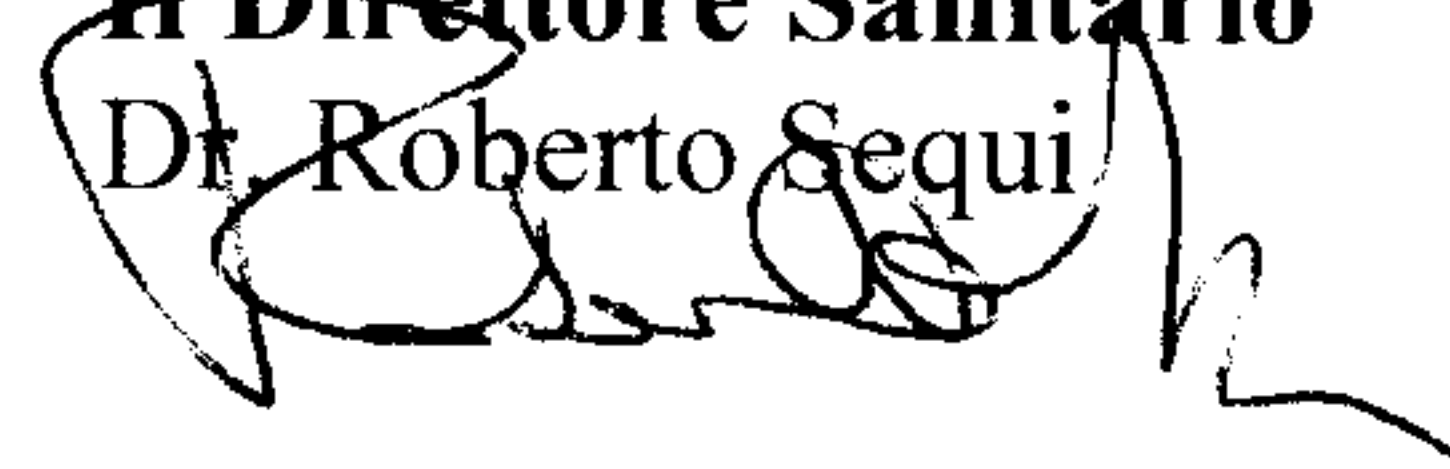

**Il Commissario**  
Dr. Antonio Garau

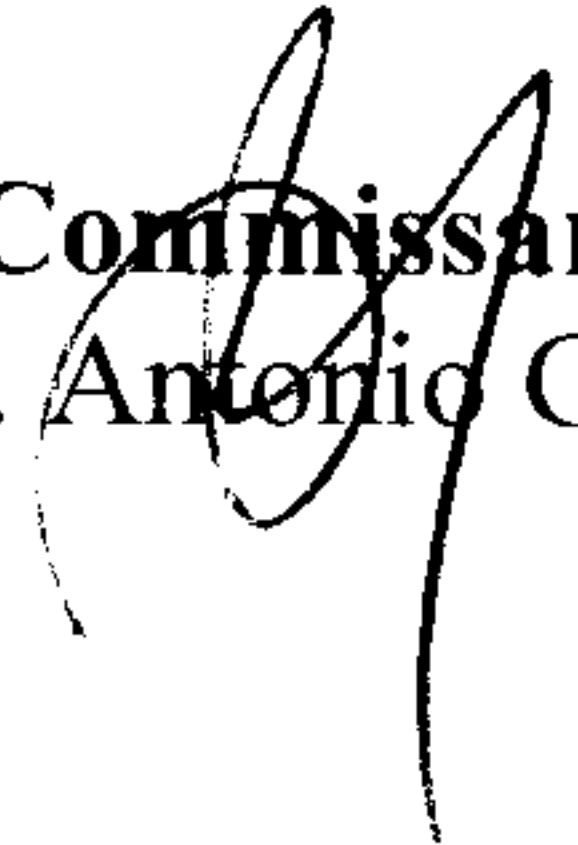

Resp.le D.P. dott.ssa Marinella Spissu



Resp. S.S. Dott. Stefano Loi  
Resp. Proc. I.A.

