

Adottata dal Commissario in data **25 LUG. 2010**

Oggetto: riparazione Telemetria modello Cic V4 .

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal **26 LUG. 2010** per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario	Dr. Antonio Garau
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dr. Bruno Simola
Direttore Sanitario	Dr. Roberto Sequi

Acquisita la richiesta 2010040/10.02.2010 della S.C. Cardiochirurgia, si rende necessario provvedere per la riparazione della Telemetria GE Healthcare Clinical Systems srl modello Cic V4 – matricola JA106104441GA al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività del citato Servizio.

Atteso che la S.S. Fisica e Tecnologia, ha individuato la Ditta **GE Healthcare Clinical Systems srl** quella più idonea per l'esecuzione del lavoro richiesto, in quanto Fabbricante dell'apparecchiatura di detta apparecchiatura, richiedendo preventivo di spesa .

Considerato che il preventivo di spesa n. 10465/22.03.2010 formulato dalla Ditta **GE Healthcare Clinical Systems srl** è di Euro **583,36** Iva inclusa.

Recepito che il Responsabile di Fisica e Tecnologia Sanitaria ha dichiarato che il prezzo è congruo.

Verificata la Legge Regionale 10/97 .

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.

DELIBERA




Ai sensi delle normative vigenti affidare alla Ditta **GE Healthcare Clinical Systems srl** l'esecuzione dei lavori di riparazione dell'apparecchiatura in oggetto.

Demandare al Responsabile di Fisica e Tecnologia Sanitaria il controllo/verifica sulla regolare esecuzione dei lavori di riparazione svolti dalla Ditta.


Imputare la spesa sul Conto n. 0507020103.

Trasmettere al Servizio Bilancio la documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della esecuzione dei lavori svolti, per l'emissione dell'ordine di pagamento di Euro **583,36** alla Ditta **GE Healthcare Clinical Systems srl**.

Il Direttore Amministrativo
Dr. Bruno Simola

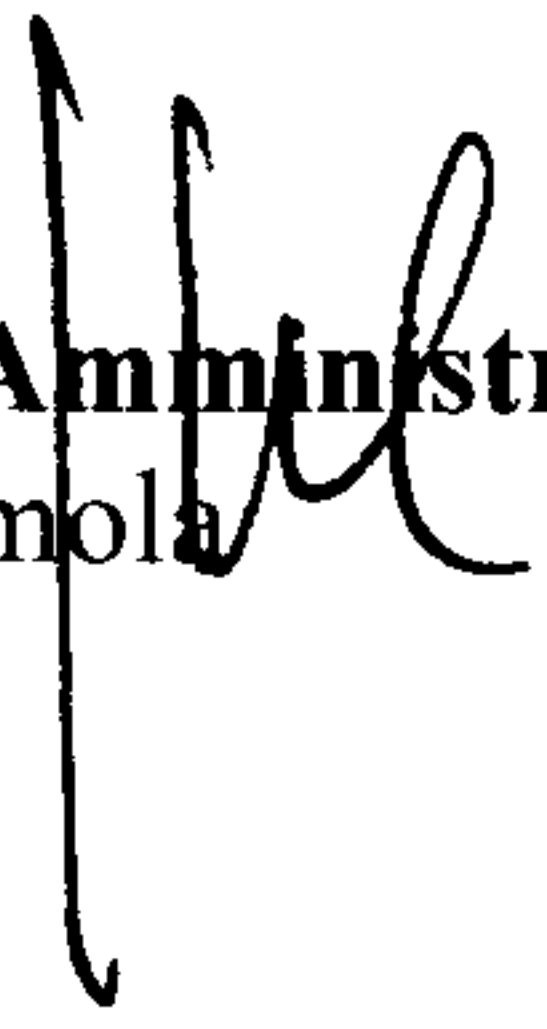

Il Direttore Sanitario
Dr. Roberto Sequi

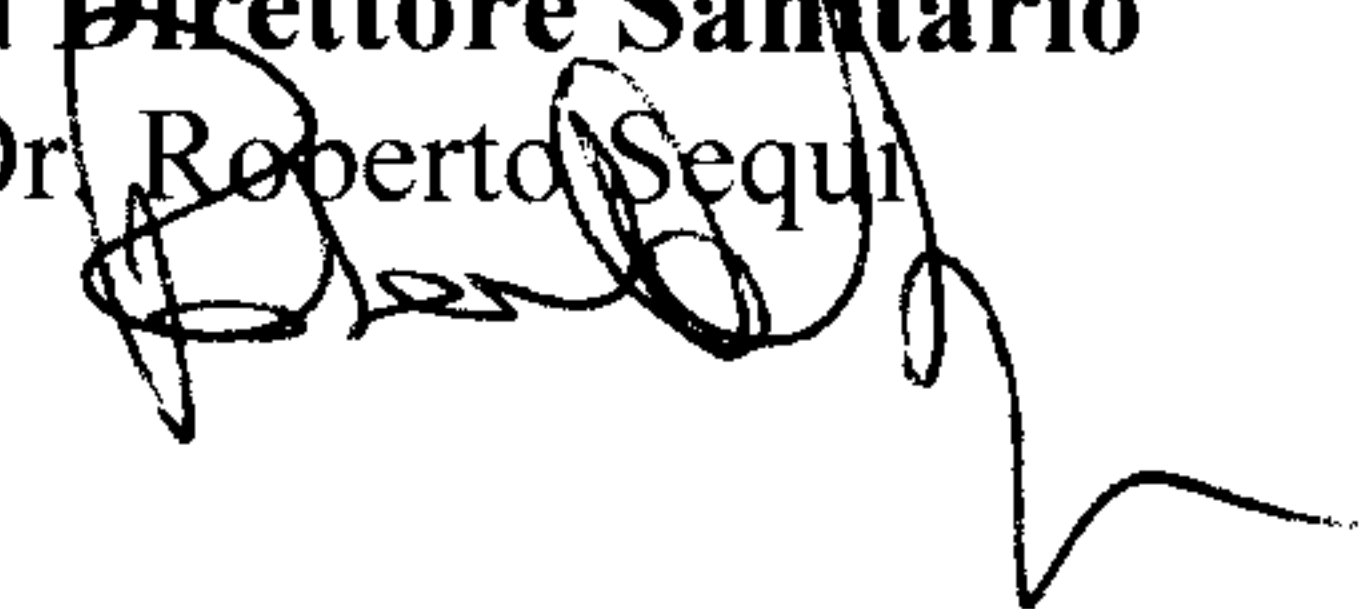

Il Commissario
Dr. Antonio Garau



Direttore Presidio dott.ssa Marinella Spissu



Resp. S.S. Dott. Stefano Loi
Resp. Proc. I.A.

